



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัส 2436 วันที่ 1 ก.ย. 64
 เวลา 14.57

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมาย งานนิติการสัญญา โทร. ๒๓๘๖

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๕(๑)/๕๕๖ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือเลขที่ อว ๐๖๐๓.๐๗.๐๑/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับให้บริการของอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต่อมา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ และมอบกองกฎหมายดำเนินการนำเสนออธิการบดีลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น


ในการนี้ กองกฎหมายได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


โดย คณบดี


- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวดวงใจ ภาควิชา จก. และ
 พวช.ภาควิชาเงิน มีอปฏิบัติ และแจ้ง
 ชงษาสัมพันธ์ ชงษาศตวรรษ


 1 ก.ย. 64

๑๑๕
 1 ก.ย. 64


 (นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย)
 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

พท
 ๑ แจ้ง ผอ.รท. ก.ท. ๑๕๖๙
 ๒ แจ้ง คณ. ผ. รท. ๑๕๖๙

 1 ก.ย. 64



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร
และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.....

เพื่อให้การบริการทางวิชาการของห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือแปรรูปอาหาร และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ความในข้อ ๓ และข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

“คณะ” หมายความว่า คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร เครื่องมือวิเคราะห์อาหาร และค่าธรรมเนียมการให้บริการนอกระยะเวลาราชการ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ คณะเกษตรศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

(นางสาวนิตธา มุ่งดี)
อธิการ

ข้อ ๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

น. น

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิติฐา มุ่งดี)
นิติกร

บัญชีแนบท้าย

ประกาศมหาวิทยาลัยรัตนนคร


เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร
และเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ บัณฑิตวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. เครื่องมือแปรรูปอาหาร

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงาน ภายในอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๑	ตู้อบลมร้อนสุญญากาศ (Vacuum Oven) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕-๐๒๒-๐๕๘	๑๐๐	๔๐๐	๕๐๐
๒	ตู้อบลมร้อนไมโครเวฟสุญญากาศ (Vacuum microwave oven) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕-๐๒๒-๐๕๗	๒๐๐	๘๐๐	๑,๐๐๐
๓	ตู้อบลมร้อนอินฟราเรดสุญญากาศ (Vacuum infrared oven) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕-๐๒๒-๐๕๖	๑๐๐	๔๐๐	๕๐๐
๔	เครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดด้วย สุญญากาศ (Freeze dryer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๗-๐๘๒	๑๐๐	๔๐๐	๕๐๐
๕	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๑๐-๐๑๕-๑๔๘	๗๐	๒๘๐	๓๕๐
๖	เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๗-๐๘๑	๒๔๐	๙๖๐	๑,๒๐๐
๗	ระบบกระบวนการความดันสูงสำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร (High Pressure Processing, HPP) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๑๐-๐๑๒-๐๗๖	๒,๔๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๔๐๐ บาท/ชั่วโมง	๙,๖๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๑,๖๐๐ บาท/ ชั่วโมง	๑๒,๐๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๒,๐๐๐ บาท/ ชั่วโมง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนัชชา มุ่งดี)
นิติกร

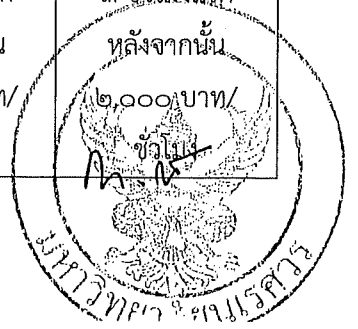


ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงาน ภายในอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๘	ชุดถังกวนผสม (Mixing tank) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๙-๒๙๒	๑๒๐	๔๘๐	๖๐๐
๙	เครื่องฉีดน้ำเชื้อภายใต้แรงดันชนิดพ่นด้วยน้ำ (Water spray retort) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๓๐-๐๑๗-๐๖๘	๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง (Batch) รวมการใช้เครื่อง กำเนิดไอน้ำ	๔,๐๐๐ บาท/ครั้ง (Batch) รวมการใช้เครื่อง กำเนิดไอน้ำ	๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง (Batch) รวมการใช้เครื่อง กำเนิดไอน้ำ
๑๐	เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบแก๊ส หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๓๐-๐๑๗-๐๖๘(๑)	๘๐	๓๒๐	๔๐๐
๑๑	เครื่องให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุแบบ สายพาน (Radio frequency heating machine) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๘๕-๐๑๗-๐๑๐	๓๐๐	๑,๒๐๐	๑,๕๐๐
๑๒	เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ (Twin screw extruder) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๓๐	๒,๔๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๒๐๐ บาท/ชั่วโมง	๘,๖๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๘๐๐ บาท/ชั่วโมง	๑๒,๐๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๑,๐๐๐ บาท/ ชั่วโมง
๑๓	เครื่องอัดรีดอาหารเม็ดหยาบ (Collet extruder) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๓๑	๑,๐๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๑๐๐ บาท/ชั่วโมง	๔,๐๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๔๐๐ บาท/ชั่วโมง	๕,๐๐๐ บาท/ ๓ ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น ๕๐๐ บาท/ชั่วโมง
๑๔	เครื่องซีลระบบสุญญากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๒๙	๑๐๐	๔๐๐	๕๐๐
๑๕	เครื่องซีลระบบสุญญากาศ/เติมแก๊ส หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๒๙(๑)	๖๐	๒๔๐	๓๐๐
๑๖	เครื่องซีลลำเลียงระบบปิดปากถุงเติมแก๊ส หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๒๘	๑๒๐	๔๘๐	๖๐๐

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนัชชา มุ่งดี)
นิติกร

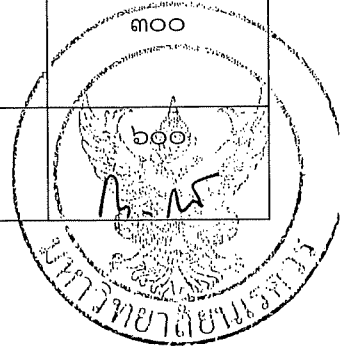

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงาน ภายในอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๑๗	เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่อง แนวนอน หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๑๐-๐๑๗-๐๖๘(๕)	๖๐	๒๔๐	๓๐๐
๑๘	ตู้แช่ติดลบแบบลมเย็น (Air blast freezer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๔๗-๑๗๑	๖๐	๒๔๐	๓๐๐
๑๙	เครื่องผสมอาหารแบบยกโถขนาด ๗ คิว หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๒๕	๑๐	๔๐	๕๐
๒๐	เครื่องผสมอาหารแบบยกหัวขนาด ๕ คิว หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๒๖	๑๐	๔๐	๕๐
๒๑	เครื่องผสมอาหารแบบยกโถขนาด ๕ คิว หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๓๐-๐๐๓-๐๒๗	๑๐	๔๐	๕๐
๒๒	เตาอบไฟฟ้า ๖ ถาด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๔๐-๐๓๑-๑๓๘	๗๐	๒๘๐	๓๕๐
๒๓	เครื่องปั่นอาหาร (Colloid mill) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๙๐-๐๐๗-๐๑๘	๑๒๐	๔๘๐	๖๐๐
๒๔	เครื่องทำไอศกรีมแบบซอฟท์เสิร์ฟ (Soft- serve ice cream machine) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๑๐-๐๑๘-๐๓๔	๕๐	๒๐๐	๒๕๐

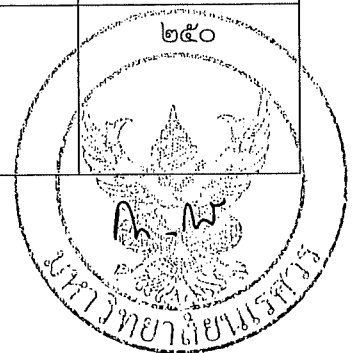

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนัชรา มุ่งดี)
นิติกร


๒. เครื่องมือวิเคราะห์อาหาร

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย นเรศวร (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงานอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๑	เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว สมรรถนะสูง (High Performance - Liquid Chromatography, HPLC) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๕๐-๐๔๕	๒๕	๑๐๐	๕๐๐
๒	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตร มิเตอร์ (Gas Chromatography- Olfactometry-Mass Spectrometry - GC-O-MS) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๕๐-๐๔๖	๒๕ (Direct Inject)	๑๐๐ (Direct Inject)	๑,๐๐๐ (Direct Inject)
		๑๒๕ (SBSE, SPME)	๕๐๐ (SBSE, SPME)	๑,๕๐๐ (SBSE, SPME)
๓	เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๔๖-๐๔๖	๑๐๐	๔๐๐	๘๐๐
๔	เครื่องวัดคุณภาพของก้อนแป้ง (Dough analyser) หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๑๐-๐๒๗-๑๓๘	๑๐๐	๔๐๐	๘๐๐
๕	เครื่องตรวจวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Texture analyser) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๙๕-๐๒๘-๐๐๗	๒๕	๑๐๐	๕๐๐
๖	เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยในอาหาร (Food fiber analyser) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๘๕-๐๑๗-๐๐๙	๓๕	๑๔๐	๒๐๐
๗	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน โปรตีนอัตโนมัติ (Automatic Nitrogen protein analyser) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๔๐-๐๓๘-๐๕๓	๒๕๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐

สำเนาถูกต้อง

อมอง


(นางสาวธนัชฐา มุ่งดี)
นิติกร

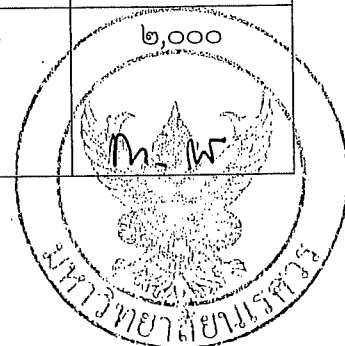

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย นเรศวร (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงานอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๘	เครื่องวิเคราะห์ความชื้นแบบอินฟราเรด (Moisture content analyser by IR) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๕๑-๐๑๐	๒๕	๑๐๐	๒๐๐
๙	เครื่องวิเคราะห์ค่าปริมาณน้ำอิสระ (Water activity analyser, Aw) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๕-๐๐๒- ๐๑๖	๒๕	๑๐๐	๒๐๐
๑๐	ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงและการ รั่วซึมของการปิดผนึกถุงบรรจุภัณฑ์ (Seal Strength and Leak Integrity Tester) หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔๑๖-๐๐๘-๐๒๒	๒๕	๑๐๐	๒๐๐
๑๑	เครื่องวัดออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และ คาร์บอนมอนอกไซด์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๕๐-๐๐๔-๑๑๒	๒๕	๑๐๐	๒๐๐
๑๒	เครื่องวัดเอทิลีน ออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๕๐-๐๐๔-๑๑๓	๒๕	๑๐๐	๒๐๐
๑๓	เครื่องนับโคโลนีอัตโนมัติ (Automatic colony counter) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๙๕-๐๒๘-๐๐๘	๑๕	๕๐	๑๐๐
๑๔	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ (Fluorescence Microscope) หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๗๓๐-๐๐๖-๑๓๖๐	๔๐	๑๕๐	๒๐๐
๑๕	เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบสเปคโตรโฟโต มิเตอร์ (Color analyzer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๕-๐๒๑-๐๑๒	๒๕	๑๐๐	๕๐๐

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนัชชา มุ่งดี)
นิติกร

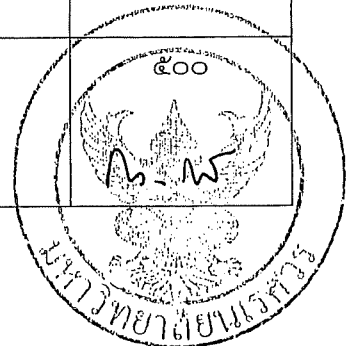


ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย นเรศวร (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงานอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๑๖	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -๘๐ องศาเซลเซียส (Deep freezer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๑๐-๐๐๙-๐๐๙	๒๕ บาท/วัน หรือ เหมาจ่าย ๓๗๕ บาท/เดือน/ลบ.ฟุต	๑๐๐ บาท/วัน หรือเหมาจ่าย ๑,๕๐๐ บาท/ เดือน/ลบ.ฟุต	๑๒๐ บาท/วัน หรือเหมาจ่าย ๑,๗๕๕ บาท/ เดือน/ลบ.ฟุต
๑๗	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร (Microplate reader) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๗๓๐-๐๐๑-๐๒๖	๕๐	๒๐๐	๔๐๐
๑๘	เครื่องเนียร์อินฟราเรด (Near-Infrared spectrophotometry, NIR) หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๑๐-๐๒๖-๐๔๘	๑๒๐	๒๘๐	๔๐๐
๑๙	เครื่องปั่นตกตะกอนและแยกองค์ประกอบ สารตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิต่ำ (Refrigerated ultracentrifuge) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๑-๐๐๔-๑๙๕	๕๐	๒๐๐	๔๐๐
๒๐	เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๗-๐๖๖	๑๕	๕๐	๑๐๐
๒๑	กล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตาสำหรับ งานวิจัย พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๗๓๐-๐๐๖-๑๓๕๘	๔๐	๑๕๐	๒๐๐
๒๒	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๗๐-๐๐๔-๐๐๑- ๐๗๔	๑๐๐ บาท/วัน	๔๐๐ บาท/วัน	๑,๐๐๐ บาท/วัน
๒๓	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ๓-๕๐ องศาเซลเซียส หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕-๐๑๕-๐๒๘ , ๖๖๖๕-๐๑๕-๐๒๙	๕๐ บาท/วัน	๒๐๐ บาท/วัน	๕๐๐ บาท/วัน

สำเนาถูกต้อง


นางสาว...

(นางสาวธนัชชา มุ่งดี)

บิณฑกร

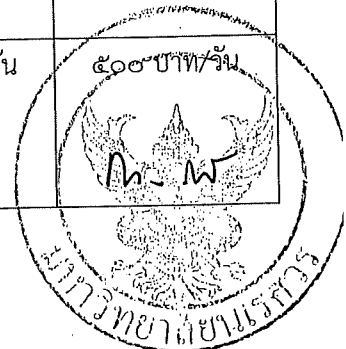

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย นเรศวร (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงานอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๒๔	ตู้ปลอดภัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๔๖-๐๙๔	๑๕	๕๐	๗๐
๒๕	ตู้ดูดความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๔๒-๑๐๑, ๗๑๑๐-๐๔๒-๑๐๒	๑๕	๕๐	๗๐
๒๖	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๓๑๐-๐๑๗-๐๖๕	๑๕	๕๐	๗๐
๒๗	ตู้ปลอดภัยชนิดไบโอฮาร์ซาร์ด หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑๐-๐๔๖-๐๙๕	๒๐	๘๐	๑๐๐
๒๘	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย ในช่วงยูวี-วิสิเบิล หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๗๓๐-๐๐๑-๐๒๔, ๖๗๓๐-๐๐๑-๐๒๕	๕๐	๒๐๐	๓๐๐
๒๙	เครื่องวัดสีแบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๑๐-๐๒๗-๑๓๗	๒๕	๑๐๐	๕๐๐
๓๐	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างมิลลิโวลท์ การนำไฟฟ้า ความเค็ม ทีดีเอส ออกซิเจน ละลายในน้ำ และอุณหภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๙๕-๐๒๒-๐๑๙, ๖๖๙๕-๐๒๒-๐๒๐	๑๐	๓๐	๕๐
๓๑	เครื่องกลั่นระเหยสารภายใต้ระบบ สุญญากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๑๐-๐๐๙-๐๕๕	๑๐	๓๐	๕๐

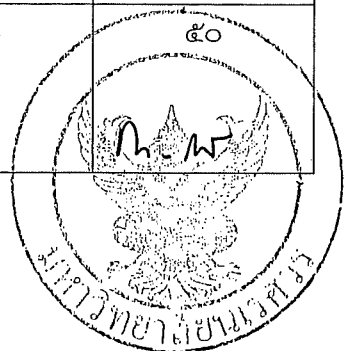

สำเนาถูกต้อง


๘๒๐๗๗
(นางสาวธนัชชา มั่งดี)
นิติกร

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย นเรศวร (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงานอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๓๒	ชุดตู้อบควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบ และประเมินอายุการเก็บรักษาของ ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕-๐๑๕-๐๒๗	๕๐ บาท/วัน	๒๐๐ บาท/วัน	๕๐๐ บาท/วัน
๓๓	ชุดตู้อบควบคุมอุณหภูมิปานกลาง-สูง สำหรับทดสอบและประเมินอายุการเก็บ รักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕-๐๑๕-๐๒๖	๕๐ บาท/วัน	๒๐๐ บาท/วัน	๕๐๐ บาท/วัน
๓๔	อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๗-๐๐๑- ๐๓๕	๑๕	๕๐	๗๐
๓๕	อ่างน้ำระบบอัลตราโซนิค หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๑๗-๐๐๑- ๐๓๖	๑๕	๕๐	๑๐๐
๓๖	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๐-๐๔๖-๐๔๔, ๖๖๓๐-๐๔๖-๐๔๕	๑๐	๓๐	๕๐
๓๗	เครื่องทดสอบพฤติกรรมคาร์ไพลของสสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๑๐-๐๐๘-๐๒๓	๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๕๐๐
๓๘	เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้าอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๗๐-๐๐๔-๐๐๑- ๐๗๘	๒๐๐	๘๐๐	๑,๐๐๐
๓๙	เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิง พลังงาน (Differential Scanning Colorimeter, DSC) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๕-๐๗๒-๐๐๙	๕๐๐	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐

สำเนาถูกต้อง

๒๖/๐๓/๒๕๖๕

(นางสาวธนัชชา มุ่งดี)

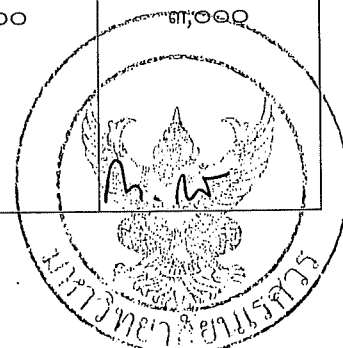

ลำดับ ที่	ชื่อเครื่องมือ	หน่วยงาน/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย นเรศวร. (บาท/ชั่วโมง)
		คณะ (บาท/ชั่วโมง)	หน่วยงานอื่น (บาท/ชั่วโมง)	
๔๐	เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนด้วย วิธีเผาไหม้ (Bomb Colorimeter) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๓๕-๐๗๒-๐๐๙(๘)	๕๐	๒๐๐	๒๕๐

๓. ค่าธรรมเนียมการให้บริการนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

การให้บริการ	อัตราค่าธรรมเนียม	
	ต่อชั่วโมง (บาท)	ต่อวัน (บาท)
นอกเวลาราชการในวันทำการ	๕๐	๒๐๐ (เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น.)
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์	๖๐	๔๒๐ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

หมายเหตุ

๑. SBSE : Stir Bar Sorptive Extraction, SPME : Solid Phase Micro Extraction, IR : Infrared
๒. อัตราค่าบริการนี้ผู้ที่ขอใช้บริการมาใช้งานเครื่องมือต้องปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือ
๓. กรณีการให้บริการนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศฉบับนี้
๔. กรณีอัตราค่าบริการเป็นเรียกเก็บเป็นรายชั่วโมง กำหนดให้เศษของชั่วโมง คิดเป็น ๑ ชั่วโมง
๕. กรณีอัตราค่าบริการเป็นเรียกเก็บเป็นรายวัน กำหนดให้เศษของวันเกิน ๖ ชั่วโมง คิดเป็น ๑ วัน
๖. อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมี
๗. ยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร



สำเนาถูกต้อง

๒๖/๐๓

(นางสาวธนัชฐา มั่งดี)
นิติกร